

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

PORTUX 3D TEMP

Impresión de estructuras y dientes provisionales

CREALITY HALOT MAGE PRO



Software: HALOT BOX

Estos parámetros son compatibles con el software **HALOT BOX**, a partir de la **versión v4.6.0.3882** o **superior**. Recuerda actualizar el Firmware de la impresora para evitar problemas de compatibilidad y que los parámetros ingresados funcionen correctamente.

Los resultados en la impresión de las estructuras dentales dependen de:

- ✓ Un adecuado protocolo en el equipo de impresión (calibración, limpieza del LCD, estado de la bandeja de impresión, entre otros)
- ✓ Un correcto manejo del software de impresión (soportes u orificios de drenaje para permitir el flujo de resina y la distribución adecuada)

IMPORTANTE: El valor del parámetro *Exposure Time* debe ser considerado como una base o punto de partida. Se recomienda imprimir primero el calibrador *Probeta Scoring PORTUX* para determinar el valor ideal del tiempo de exposición su impresora.

Parámetros de impresión

Parameters name: PORTUX 3D Temp

Normal mode Dynax mode

Global settings

Layer Thickness	0.05	mm
Rising Height	8	mm
Motor Speed	1	mm/s
Light-off Delay	1	s

Regular part

Exp	1.5	s
-----	-----	---

Bottom part

Initial Exposure	30	s
Bottom Layer Count	2	





Compensación de contracción


X-axis Shrinkage Compensation	100.00	%
Y-axis Shrinkage Compensation	100.00	%
Z-axis Shrinkage Compensation	100.00	%
XY-axis Contour Compensation	0.000	
<input type="checkbox"/> Enable Z-axis Penetration Compensation		
Z-axis Penetration Compensation	1	
<input type="checkbox"/> Enable Anti-aliasing		
Grey Value Range	1	255
<input type="checkbox"/> Image Blur		
Image Blurred Pixels	2	
<input type="checkbox"/> GPU Acceleration		


Orientación de impresión

El posicionamiento y orientación adecuada de las estructuras a imprimir es vital para garantizar adaptaciones y sellos correctos. Se recomienda entonces lo siguiente:

- Nunca colocar soportes sobre las superficies de sellado o adaptación de la estructura.
- Para estructuras individuales y/o tramos posteriores se recomienda una orientación por la **cara palatina**, esto garantiza la mayor cantidad de detalles en la cara oclusal.
- Para carillas, estructuras individuales y/o tramos anteriores se recomienda una orientación por la **cara incisal**.

Imágenes de referencias para el posicionamiento de piezas dentales

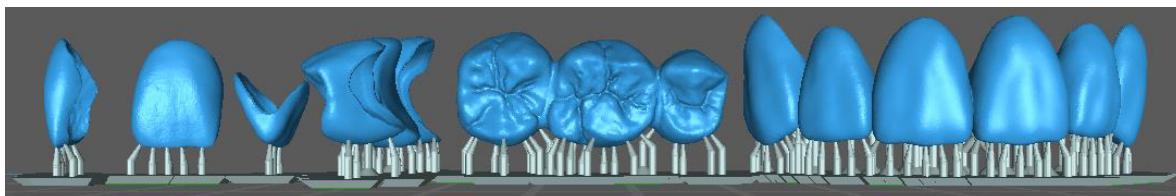

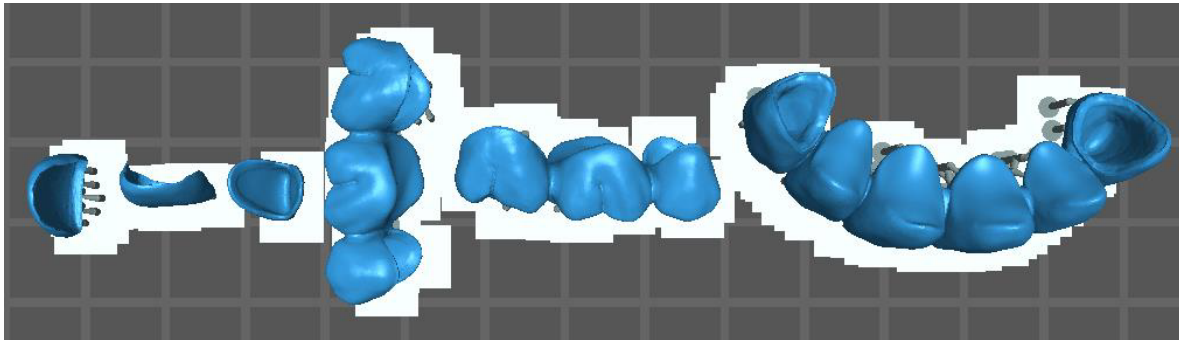

SOPORTES	
PARÁMETRO	VALOR
Soportes	Medium
Density (%)	85 - 90
Support Min Length (mm)	4

Indicaciones para la limpieza y poscurado de las estructuras dentales

1. **Retirar el exceso de resina** una vez finalizada la impresión, para esto se recomienda utilizar espátulas de plástico o silicona. Despegar las estructuras de la plataforma de impresión y sumergirlas en un recipiente con alcohol isopropílico (>97%) o alcohol etílico industrial (>96%) por 5 minutos en baño ultrasónico preferiblemente.
2. **Transferir las estructuras a un segundo recipiente con alcohol** limpio por 5 minutos en baño ultrasónico para garantizar una limpieza más profunda. Para retirar el exceso de resina de las zonas con cavidades es posible utilizar un cepillo o pincel de cerdas suaves.
3. Terminado el ciclo de lavado, **secar las estructuras con aire comprimido**, o en una estufa a 40°C por 30 minutos, verificar que no haya residuos líquidos de resina o partes pegajosas. Si existe presencia de residuos, repetir los pasos anteriores.
4. Disponer las estructuras en **la cámara de poscurado** de forma tal que queden distribuidas en toda la superficie. El correcto poscurado garantiza las propiedades físicas óptimas para su aplicación, es posible evidenciarlo cuando se obtiene un cambio de color en las estructuras y el acabado superficial es liso. Exceder los tiempos de lavado de las estructuras en alcohol, puede afectar las propiedades mecánicas, la adaptación, la tonalidad final de las piezas, entre otras características importantes.
5. Se recomienda curar las estructuras bajo luz UV en una cámara Anycubic Wash and Cure durante 40 minutos.